

# Traçabilité des dispositifs médicaux implantables au bloc opératoire : un enjeu sanitaire et financier



C. LUIZARD, L. DUBRET, A. PONT, B. CORET-HOUBART  
Pharmacie, CHI Robert Ballanger, Boulevard Robert Ballanger, 93600 Aulnay-sous-Bois



## INTRODUCTION

La traçabilité des dispositifs médicaux implantables (DMI) au bloc opératoire (BO) est réalisée manuellement puis transmise à la PUI sur support papier pour saisie informatique.



**Objectif**  
Evaluer l'exhaustivité de la traçabilité et le coût financier des produits hors GHS non tracés


## MATERIEL ET METHODE

- Etude rétrospective sur 2013
- Comparaison :



- Traçabilité sanitaire (TS) : Ecarts en quantité pour tous les DMI
  - Traçabilité financière (TF) : Ecarts en valeur (TTC) pour les DMI hors GHS
- Analyse des écarts

## RESULTATS - DISCUSSION

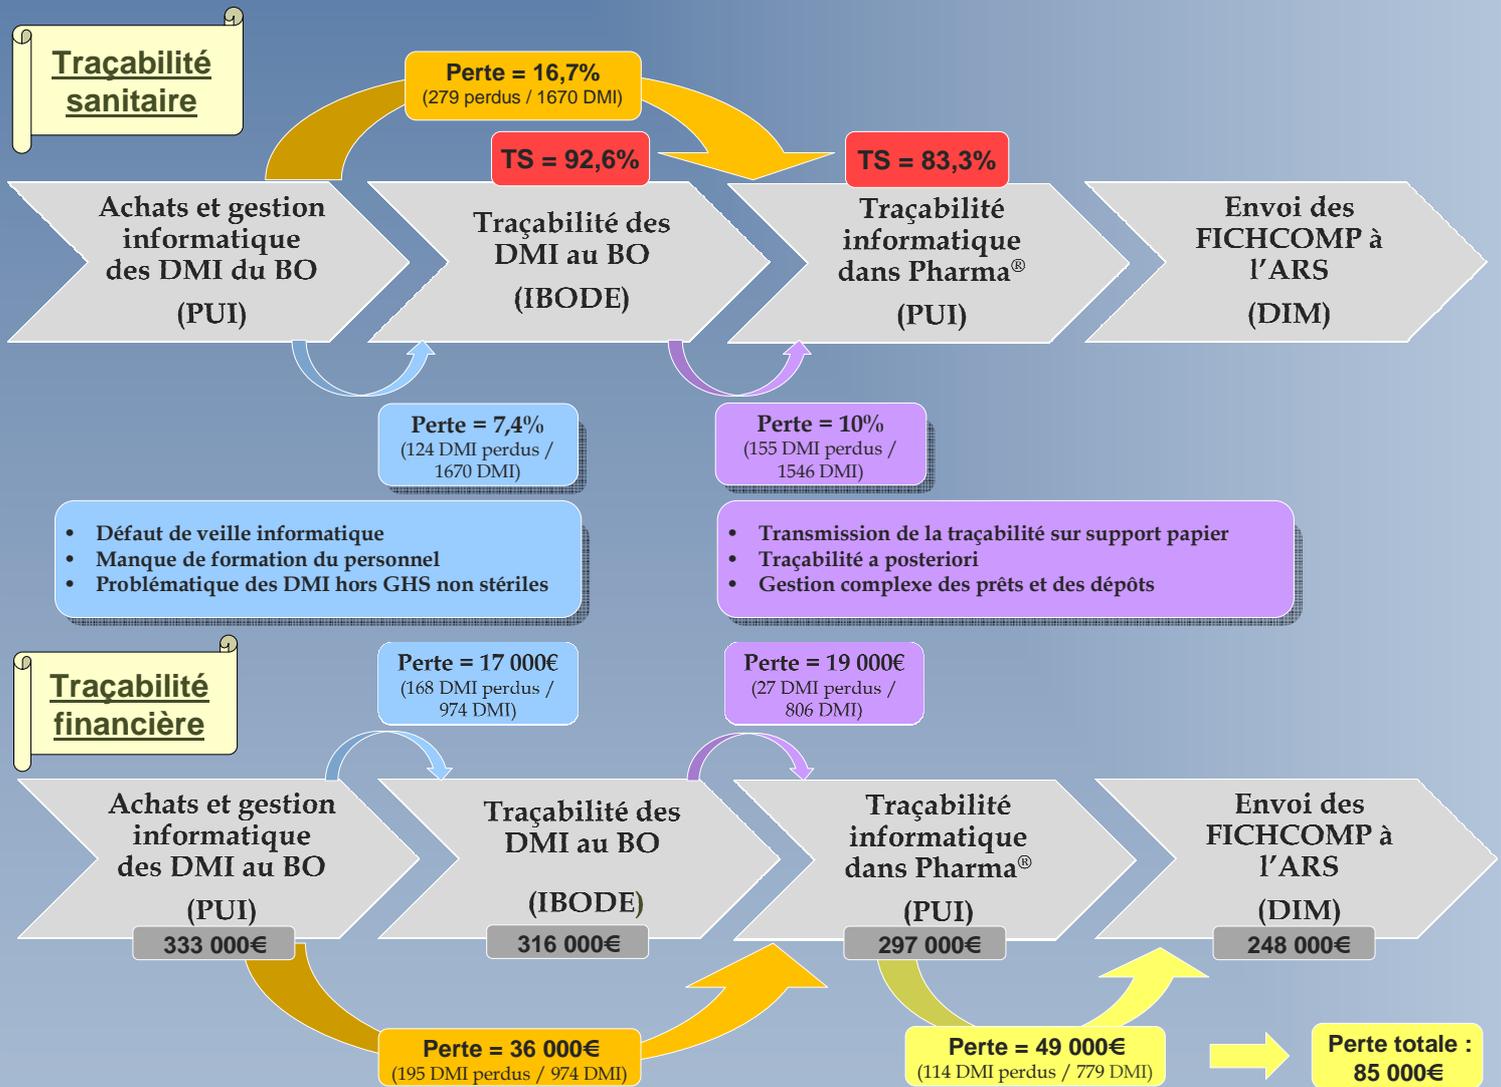

## CONCLUSION

Cette étude a identifié un défaut important d'exhaustivité de la traçabilité sanitaire et financière. La perte financière qui en résulte représente 42% (36 000€) du déficit total constaté (85 000€). Outre les actions correctives sur le circuit (informatisation de la traçabilité en temps réel, formation du personnel, mise à jour du logiciel), le suivi des fichiers envoyés à l'ARS a été optimisé.